

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 471/54 (พบ.)  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-3473  
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัส อาร์ เอส วี  
( Respiratory Syncytial Virus )  
หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส RSV ในตัวอย่างส่งตรวจที่เป็น Nasopharyngeal Aspirate ของผู้ป่วย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นการตรวจโดยใช้หลักการ Immunochromatography ในการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส RSV

1.2.2 สามารถอ่านผลจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบภายในระยะเวลา 10-15 นาที

1.2.3 มีแถบควบคุม (Control Line) เพื่อควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ

1.2.4 มีชุดควบคุมผลบวก (Positive Control) และตัวควบคุมผลลบ (Negative Control) สำหรับควบคุมคุณภาพในกล่อง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปพร้อมแถบทดสอบชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีเอกสารกำกับ ระบุรายละเอียด วิธีการใช้ และวิธีเก็บรักษา


3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.  ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

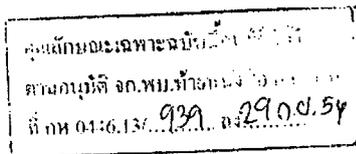
พ.อ.  ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )

พ.อ.หญิง  ..... ผช.ผอ.กพธ.รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( อุไรวรรณ แก้ววอร์ )

29 ก.ย. 2554



**สำเนาถูกต้อง**

พ.อ.  .....

( วิชาญ พงศ์ม สายปุงคล้า )

พ.อ.กพธ.รพ.ค่ายสุรนารี